


当院で使用している、KaVo 3D eXam i 歯科用CTは医科用CTと比べて10%未満の被曝線量で撮影しますので、安心して検査を受けていただけます。

☆ 実効線量比較 (mSv) ☆

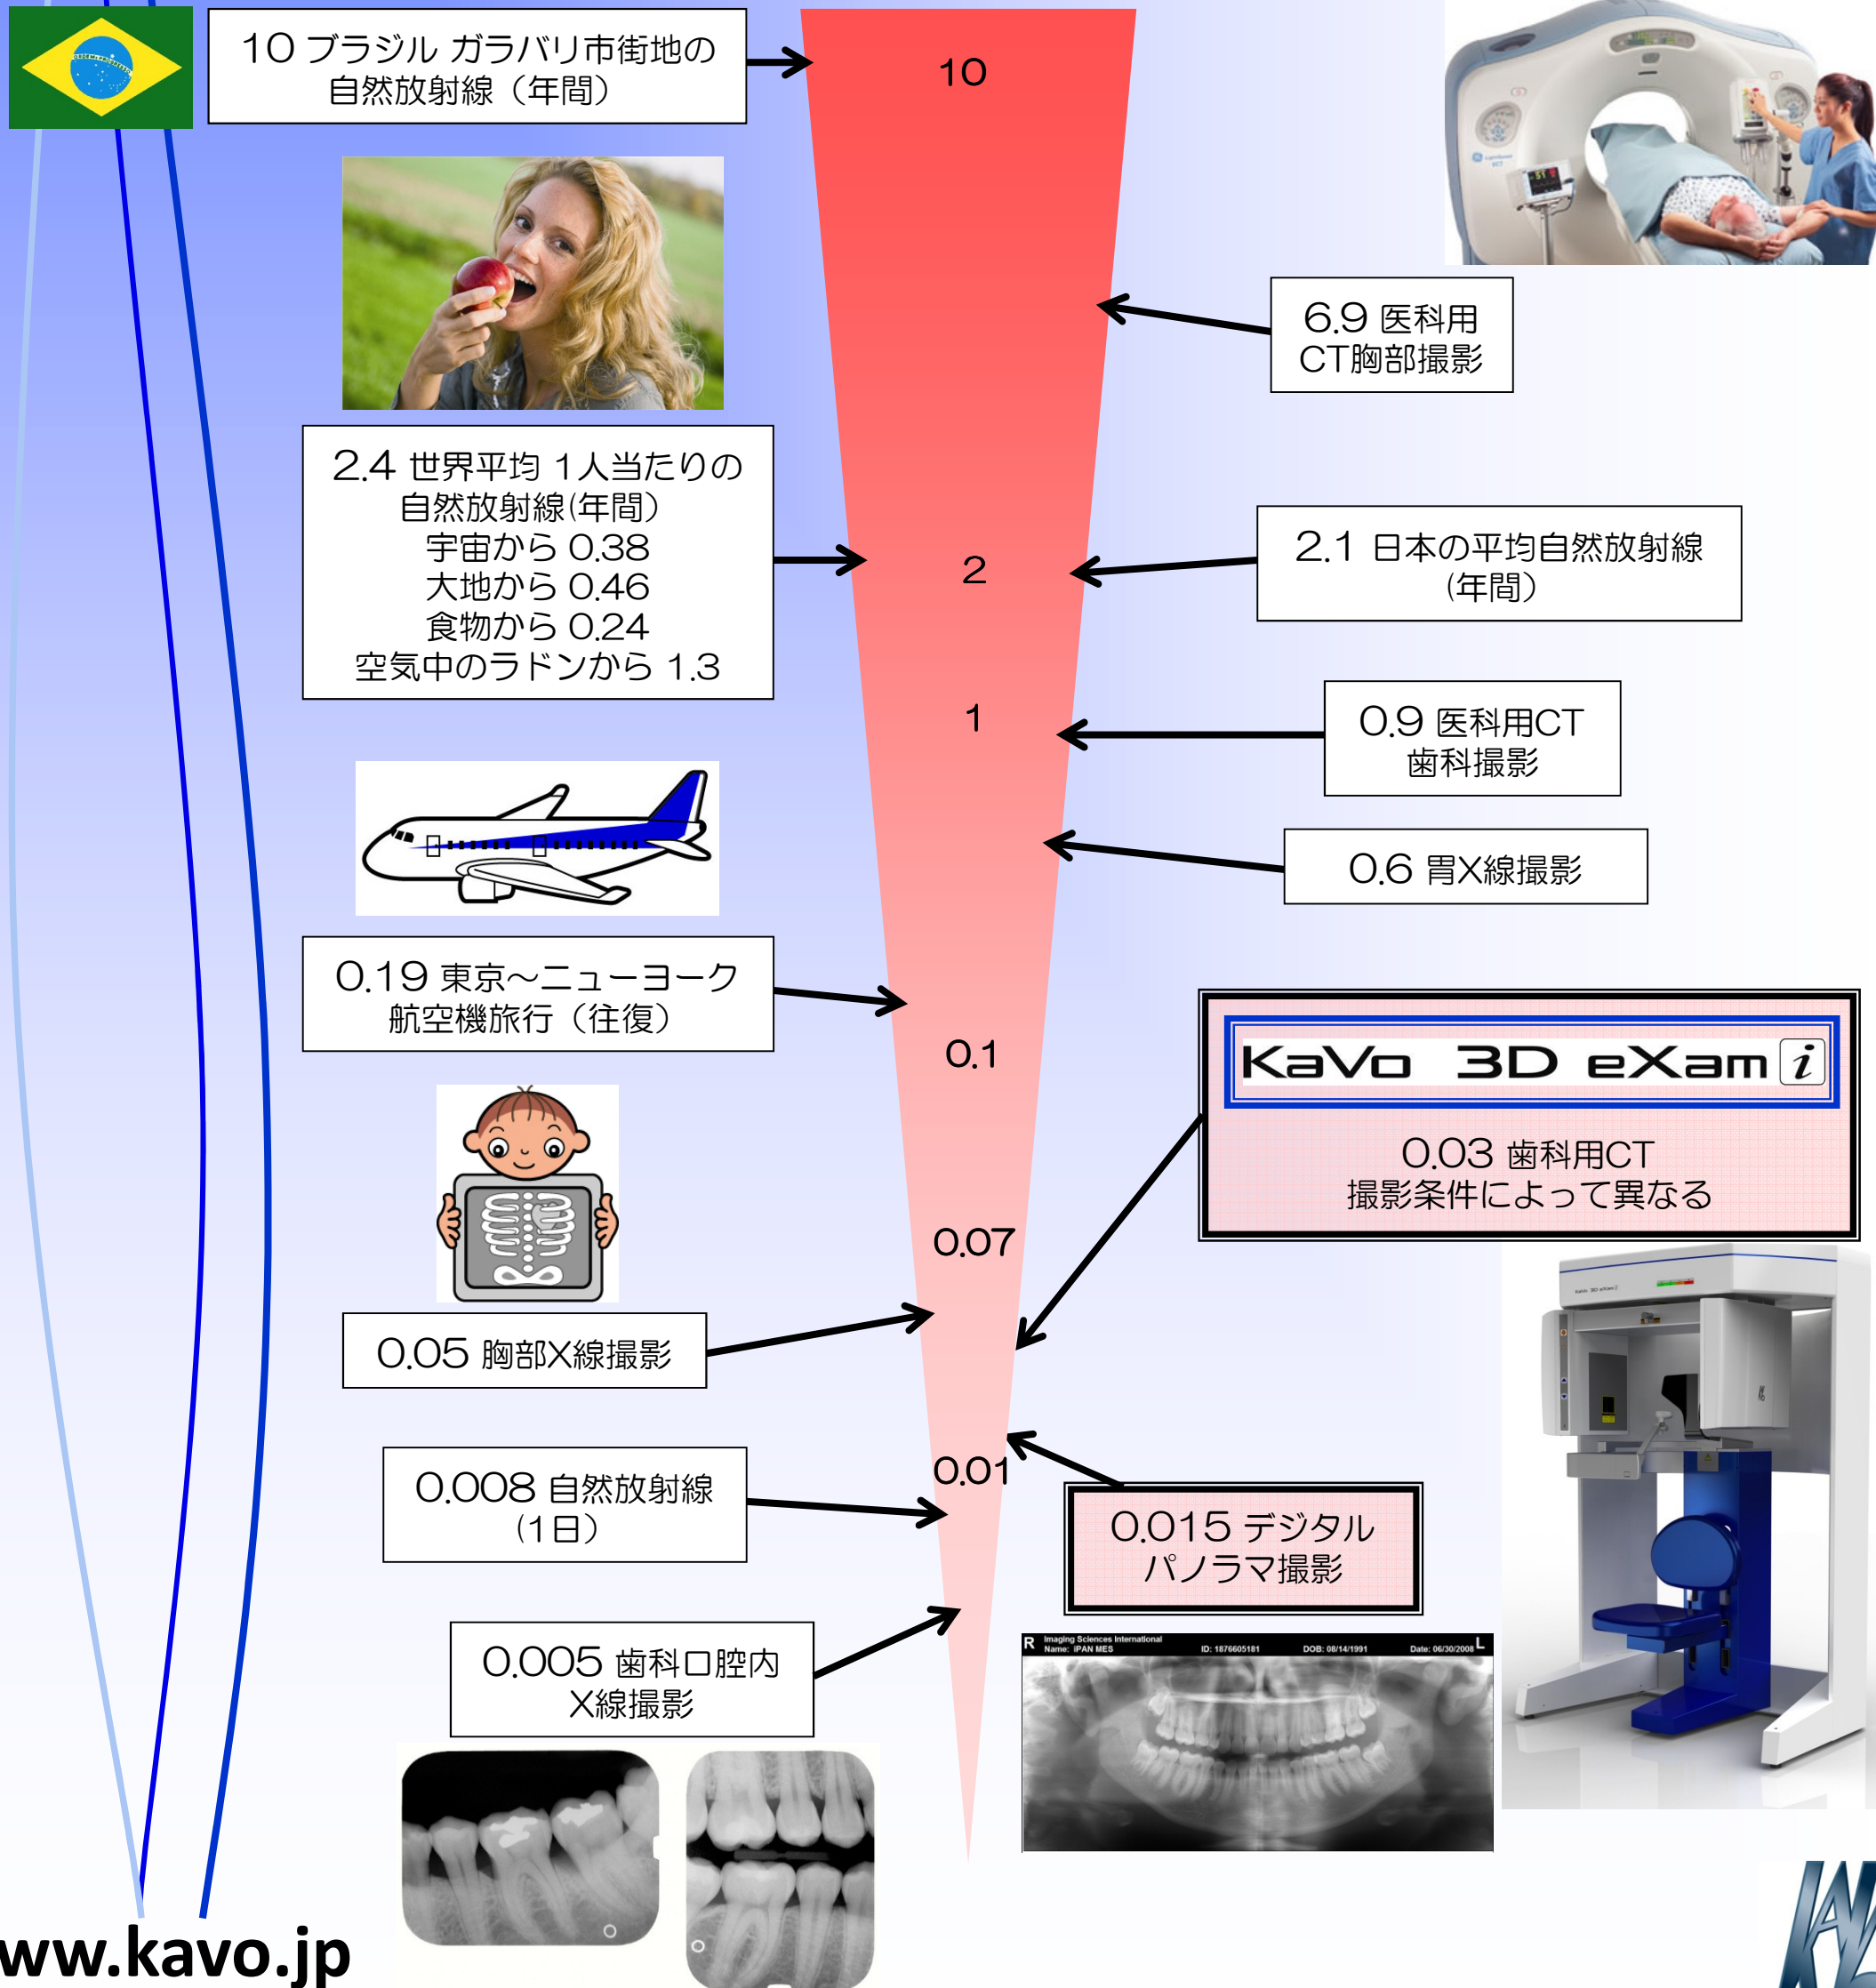

www.kavo.jp

ENHANCING THE WAY YOU SEE PATIENTS.

